



16.07.2020

## Richiamo preventivo delle mascherine igieniche

La farmacia dell'esercito effettua un richiamo preventivo dei seguenti prodotti:


a) Numero d'articolo

2582.2862 / MASCHERINA IGIENICHA 175X100MM VLIES, EN14683 TYP 2, CON 2 ELASTICI FREMDE (Lot (09-12/2007-) WH 365/1-13)

2545.4257 / MASCHERINA IGIENICHA 175X100MM VLIES, EN14683 TYP 2, CON 2 ELASTICI

(Lot (09-12/2007-) WH 365/1-13)

Fabricante: WIROS GmbH, D-47798 Krefeld, Deutschland

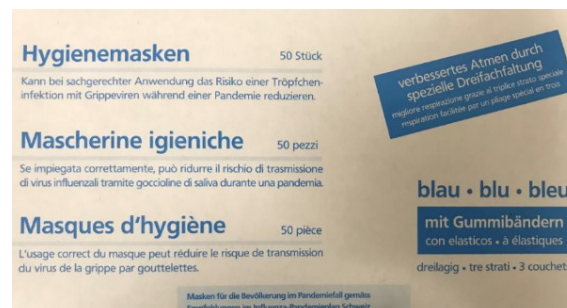

b) Numero d'articolo

5124.1010 / 3M

MASCHERINA IGIENICHA

(Lotto: Tutti i lotti)

Fabricante: 3M Health Care, D-4153 Neuss, Germania



## **Descrizione del problema**

Per alcuni dei prodotti sopra citati, gli utenti hanno notato un odore particolare. Ciò ha indotto un cantone a far analizzare microbiologicamente dei campioni dei prodotti. Il risultato ha mostrato che diversi campioni sono risultati positivi all'*Aspergillus fumigatus*.

Questa contaminazione è stata limitata esclusivamente ai prodotti che sono stati consegnati dalla farmacia dell'esercito a partire dal febbraio 2020. Le maschere vendute prima di questa data, in particolare anche attraverso i grossisti, non sono oggetto di questo richiamo precauzionale.

## **Misure da adottare**

- a) I prodotti sopra descritti devono essere separati dall'utente e bloccati per l'uso.
- b) I prodotti immagazzinati centralmente che non sono ancora con l'utente devono essere separati e bloccati per l'uso.
- c) Se avete rivenduto i prodotti, siete pregati di identificare i rispettivi utenti e di notificare loro immediatamente questo richiamo precauzionale e le relative misure.
- c) Gli articoli bloccati saranno ritirati alla farmacia dell'esercito, la procedura esatta sarà comunque comunicata dalla farmacia dell'esercito. Per il momento non è prevista la distruzione diretta dei prodotti da parte dell'utente finale.

Thomas Holenweg

Logistikbasis der Armee LBA  
Armeeapotheke  
Chef Bereich Medizinprodukte und –technik  
Worblentalstrasse 36  
CH-3063 Ittigen  
e-mail: : [triage-log-aapot.astab@vtg.admin.ch](mailto:triage-log-aapot.astab@vtg.admin.ch)